

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5803

证书编号:
Certificate No.



419026867


SHANGHAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO.,LTD

上海恒河计量校准有限公司

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

委托者 Customer	精楷电子科技(上海)有限公司
委托方地址 Address of customer	上海市金山区枫泾镇兴豪路7号3幢4层
器具名称 Name of instrument	压差变送器
制造厂 Manufacturer	精楷电子科技(上海)有限公司
型号/规格 Type/Specification	DP110-AA2PXP07D
出厂编号 Serial No.	2236211170003
管理编号 Asset Number	/

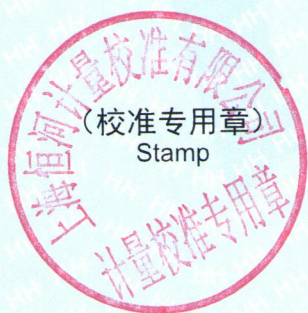

证书批准人
Approved by 张健锋 张健锋

核验员
Checked by 曹鸿贤 曹鸿贤

校准员
Calibrated by 张江 张江

接收日期 Issued Date	2022	年 Year	09	月 Month	22	日 Day
校准日期 Date of Calibration	2022	年 Year	09	月 Month	22	日 Day
签发日期 Date of Issue	2022	年 Year	09	月 Month	22	日 Day

投诉电话:021-59929758
Tel. For complaint

地址(Address): 上海市嘉定区新徕路399号11楼

电话(Tel): 021-59970995

传真(Fax): 021-59929758

邮编(Post): 201815



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5803

证书编号：
Certificate No.



419026867

SHANGHAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO.,LTD

中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号： **No.CNAS L5803**

The number of the certificate accredited by CNAS is No.L5803

本实验室为国家认可的校准实验室，校准管理及技术依据ISO/IEC 17025之要求。

This laboratory is the Metrological Calibration Institute Accredited by CNAS.
The calibration management and technical are in accordance ISO/IEC 17025.

■ 本次校准的技术依据 (Reference documents)

JJG875-2019 《数字压力计检定规程》

■ 本次校准所使用的主要计量器具(Main measurement standards used during the calibration)

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date	测量范围/技术指标 Measuring range/Technical Specifications	溯源单位 Traceability Mechanism
补偿式微压计 (-2500-2500) Pa a	HJBZ027 009	2021E21-21-31141500 01/ 2023-03-16	(-2500-2500) Pa 2等	上海市计量测试技术研究院

■ 校准地点和环境条件(Location and environmental condition for the calibration)

地点： 上海市嘉定区新徕路399号11楼力学室

Location

温度： 19.5 °C

湿度： 50 %RH

其他： /

Ambient temperature

Relative humidity

Others

■ 备注(Comments)

■特此证明本证书记载之受校仪器已与本次标准器做过比较校准，用以校准之标准器之量值可溯源至国家基准。

HH hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with this standards. The standards used to perform this calibration are traceable to those of the national primary standards in the P.R.China.

本校准证书仅对上述仪器之校准项目有效。

This calibration certificate is valid only to the items calibrated.

本校准证书部分复制无效。

Reproduced calibration certificate in partial is not effective.

“*”项目为本公司校准实验室具备的能力，而非中国合格评定国家认可委员会的认可能力。

“*”project representative calibration laboratory in this company hae the capacity,rather than CNAS accreditation capacity.

证书内页中“P”代表“Pass”，“F”代表“Fail”，“N/A”代表“Not Applicable”。

In the data sheet,“P” represents “Pass” and “F” represents “Fail” and “N/A” represents “Not Applicable”.

证书内页中“***E**”代表“***×10**”，例如“2.1E-006”代表“2.1×10-6”。

In the data sheet,“***E**” represents “***×10**”,For example, “2.1E-006” represents “2.1×10-6”.

校准证书续页专用

SHANGHAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L5803

证书编
号:
Certificate
No.



419026867

SHANGHAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO.,LTD

校准结果

Calibration Results

- 外观检查及功能性检查: 符合要求;
Appearance and function examination: Qualified;
- 示值误差:
Indication Error:

等级/Class: 0.5

标准值 Standard Value (Pa)	示值误差 Error (Pa)	回程误差 Return error (Pa)	扩展不确定度 Uncertainty $U(k=2)(\%FS)$	允许误差 Limit (Pa)	结论 Conclusion
0	0	0	0.06	± 25.0	P
2500	-5	1	0.06	± 25.0	P
5000	-7	3	0.06	± 25.0	P

说明/Remark:

本次校准结果符合上述技术要求。

The calibration results accord with above requirements.

建议复校周期: 12个月。

Recommend recalibration period :12 months.

---校准结果内容结束---

---THE END---

校准证书续页专用

SHANGHAI HENGHE METROLOGY AND CALIBRATION CO.,LTD